

## **ERRATA 002/2024**

PROCESSO LICITATÓRIO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS  
Nº 03/2024

RESOLUÇÃO SES/MG 8.984, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2023

**OBJETIVO:** Aquisição de Equipamento e Material Permanente oriundo do repasse de recurso Financeiro Estadual de Investimento Provenientes de Emenda Parlamentar, referente ao Módulo de Eletivas da Política Hospitalar – Valora Minas - Opera Mais Minas Gerais, indicação parlamentar nº 120970 conforme Resolução SES/MG nº 8.984, de 12 de setembro de 2023. Recurso transferido via Fundo Municipal de Itaúna/MG, celebrado por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa Moreira o Convênio Municipal nº 15/2023.

**OBJETO:** Aquisição de Equipamento e Material Permanente

**Item 01:** Aparelho de Anestesia acrescido de Monitor de Multiparâmetros

**Quantidade:** 01 Unidade

1- No referido processo licitatório foram realizadas as seguintes alterações:

- Página 13 Anexo I – Item 01 Aparelho de Anestesia acrescido de Monitor de Multiparâmetros Especificações Técnicas – dos parâmetros do monitor de multiparâmetros - Oximetria(SPO2):

**Onde se lê** “Faixa: 1 a 100%; precisão: medição de pulso: de 30 a 300 BPM; com acurácia: +-2% entre 80 a 100% e +-3% entre 70 e 80%. Apresentar índice de perfusão gráfica e numérica na saturação, apresentação da curva plestimográfica; Alarmes: máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor; saturação de oxigênio com tecnologia para leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo ser tecnologias Nellcor, Masimo, Fast, Mindray, ge trusignal ou blue pro. Acompanha 01(um) sensor não descartáveis de dedo adulto/pediátrico. Os acessórios fornecidos para a saturação de oxigênio deverão ser originais da marca da tecnologia ofertada, não serão aceitos acessórios compatíveis”.



## **ERRATA 002/2024**

PROCESSO LICITATÓRIO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS  
Nº 03/2024


RESOLUÇÃO SES/MG 8.984, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2023

**Leia-se** “Faixa: 1 a 100%; precisão: medição de pulso: de 30 a 300 BPM; com acurácia: +-2% entre 80 a 100% e +-3% entre 70 e 80%. Apresentar índice de perfusão gráfica e numérica na saturação, apresentação da curva plestimográfica; Alarmes: máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor; saturação de oxigênio com tecnologia para leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo ser tecnologias Nellcor, Masimo, Fast, Mindray, ge trusignal ou blue pro. Acompanha 01(um) sensor não descartáveis de dedo adulto/pediátrico. Os acessórios fornecidos para a saturação de oxigênio deverão ser originais da marca da tecnologia ofertada, não serão aceitos acessórios compatíveis”.


2- As demais disposições permanecem inalteradas.

3- A publicação desta **ERRATA 002/2024** do Processo Licitatório Cotação Prévia de Preços nº 03/2024 Resolução SES/MG 8.984, de 12 de setembro de 2023 – Convênio Municipal nº 15/2023 estará disponibilizada no mesmo endereço eletrônico do início do processo licitatório <https://hmg.org.br/>.

Itaúna/MG, 14 de agosto de 2024.




Grazielle Cristina Moréira Nogueira  
Executora de compras

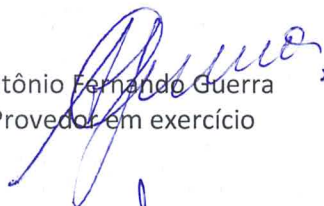

Antônio Fernando Guerra  
Provedor em exercício



Vinícius Guimarães Gomes  
Diretor técnico



Matheus dos Anjos do Nascimento  
Responsável técnico